

Nombre del Dr/a _____ Razón social _____

Teléfono _____ Correo electrónico _____

Dirección de despacho _____

Nombre del paciente _____

- Femenino Servicio urgente con costo adicional
 Masculino

CASOS DE IMPLANTES

TIPO DE PILAR

- TiBase Híbrido/Zirconio Personalizado

Por favor indique

Marca del implante _____

Medida del implante _____

Perfil de emergencia

- Contorno del tejido Desplazamiento del tejido Sin desplazamiento del tejido

ADJUNTO CON EL CASO

Impresiones

- Superior Tornillo transfer
 Inferior Rodete de altura
 Análogo Mordida
 Modelos Fotos

SI NO HAY ESPACIO OCLUSAL

- Llamar al doctor Desgastar antagonista y continuar
 Dr. Ajusta y envía nueva impresión

SERVICIOS EXTRA

- Rodete de altura Plano digital
 Base metálica Modelos 3D

MATERIAL

- Zirconio con translucidez (3D PRO)
 Zirconio con opacidad (SHTC)
 Zirconio estratificado
 Disilicato de Litio
 Metal Cerámica
 PMMA provisorio
 Ceromero (Debe enviar bloque)
 Encerado DX
 Encerado Digital

Tipo de trabajo

- Corona Carilla Inlay/Onlay
 Maryland Puente Endocrown

Diseño del pónico

-

COLOR DEL DIENTE

Color: _____

Rehabilitado en:


- Fibra de vidrio Composite
 Perno Espiga

Color del muñón _____


PLANOS DE RELAJACIÓN

- Blando-duro Superior
 Duro Inferior

DIENTE N°

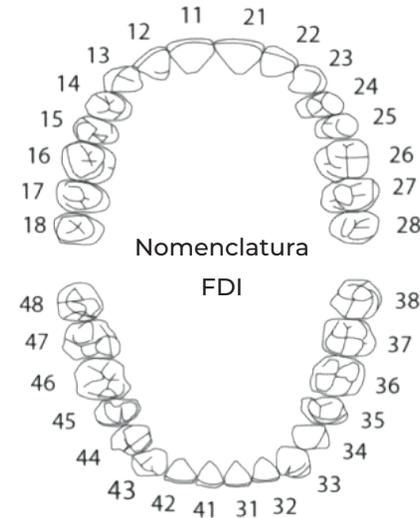

Dibuje su caracterización

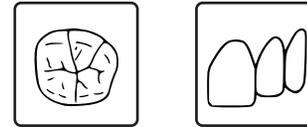

Instrucciones del caso

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Estos Términos entran en vigencia cuando el cliente establecido en el reverso del mismo ("Odontólogo") envía este formulario ("Orden de trabajo") a Dinámico dental laboratorio SPA. El ("Odontólogo") acepta un contrato para la venta y entrega de los productos especialmente fabricados mencionados en este documento ("Productos"). El ("Odontólogo") acepta pagar la totalidad del precio indicado de los productos en un pago contra entrega C.O.D durante los 3 primeros meses, una vez culminado este plazo, el ("Odontólogo") debe hacer la solicitud de crédito para pagos a 30 días contra evaluación previa del departamento de finanzas, de lo contrario continúa en modalidad C.O.D. El ("Odontólogo") debe limpiar completamente toda la sangre o saliva de todos los materiales utilizados en la boca, asimismo, debe desinfectar todos estos elementos antes de enviarlos a Dinámico y nuevamente cuando regrese de Dinámico antes de colocarlos en la boca del paciente.

1- Garantía: Las garantías proporcionadas por Dinámico dental serán condicionadas bajo los siguientes términos:
 - Problemas de manufactura: este tipo de garantía tiene un plazo máximo de 7 días luego de la entrega del trabajo a la clínica, en donde se repetirá el trabajo sin costo por error de producción: por homologar incorrectamente el color solicitado o por fracturas del material. Nos reservamos el derecho de no otorgar esta garantía en caso de que el doctor no esté de acuerdo con el trabajo final luego de su previa aprobación del diseño digital. Dinámico dental trabaja con guía Vita classic y 3D máster. Los trabajos con otra guía de color, se deberá enviar con su respectivo muestrario, de lo contrario se reserva garantía por cambio de color. - Luego del periodo de tiempo de 14 días, existe la garantía 50/50, ésta cubre el 50% del costo de la nueva pieza a realizar, siendo condicionado por:
 - Incorrecto uso del cemento: Si existiera algún cambio de color en la pieza por mala elección del color del cemento dual al momento de instalar el trabajo. - Uso incorrecto del producto por el paciente. - Fracturas en zonas de puntos de contacto prematuros que no se hayan notificado a mesa central y aun así se cemente. - Nos abstenemos de aplicar todo tipo de garantía en caso de que demos como recomendación un material para la elaboración de la rehabilitación y el doctor/a no acepte. Siempre el laboratorio aconsejará un mejor manejo según los requerimientos del trabajo y las especificaciones de nuestros materiales.
 2- Pago de los trabajos: En caso de que un trabajo supere los 30 días, el pago se debe realizar por el total de la factura emitida así no esté instalado en el paciente.
 3- Partes involucradas: Al contratar el servicio este será un acuerdo entre Dentista contratante del servicio y Dinámico dental, el dentista contratante debe hacerse cargo del pago de trabajos al laboratorio en casos de que no siga trabajando en la consulta.
 4- Rechazo de Trabajos: Contamos con un control de calidad para todos los procesos y cada uno de los trabajos recibidos, si en la impresión, los aditamentos o adicionales que llega en un caso se encuentra algún detalle que no permita continuar con el proceso, será notificado a los doctores para un nuevo envío de éste.
 5- Alcance: Dinámico dental se limitará a los trabajos tabulados en el arancel adjunto en el correo. No se aceptan trabajos iniciados por otros laboratorios, el servicio proporcionado por dinámico dental inicia con la impresión del paciente, para llevar el trabajo de inicio a fin.
 6- Entrega de los trabajos: Los casos tendrán un tiempo de desarrollo de mínimo 5 a 10 días hábiles para trabajos cementados o sobre implantes, y de 5 días hábiles para termoformados. (Éstos están sujetos al tiempo de respuesta para aprobación de diseños o consultas técnicas que imposibiliten avanzar su elaboración ocasionando retrasos). DINÁMICO LAB SPA / 77.181.414-K 2 7 -Aprobación de los trabajos: Dinámico cuenta con un servicio de diseño digital de los trabajos realizados en el laboratorio, durante el proceso del flujo de trabajo del área de CAD/CAM, el doctor debe aprobar el diseño que se le envía, ya sea por WhatsApp o correo electrónico, en este paso podrá hacer los ajustes o cambios correspondientes hasta quedar satisfecho antes de su producción, al aceptar el diseño final se reserva el término de garantía por diseño incorrecto.
 8. Precios preferenciales: Los términos y condiciones estarán sujetos a las condiciones de pago y el buen comportamiento de pago.
 9. Dinámico se reserva el derecho de cambiar los precios por motivos justificados en casos de necesidad.

TIEMPOS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO


Nuestros productos tienen un tiempo de espera estimado, por favor permita el tiempo completo para cada producto. Los tiempos de trabajo **NO incluyen** fines de semana ni días festivos. Los servicios urgentes están disponibles para la mayoría de los productos pero deben ser preprogramados.

TIPO DE PILAR


Zirconio de alta estética 3D PRO.....	5 días hábiles
Zirconio opacidad SHTC.....	5 días hábiles
Disilicato de Litio.....	5 días hábiles
Metal Cerámica.....	7 días hábiles
Zirconio sobre implante	10 a 12 días hábiles
PMMA.....	3 días hábiles
Encerado DX.....	3 días hábiles
Planos de relajación.....	3 días hábiles

GUIAS DE PREPARACIÓN PARA RESTAURACIÓN

EN CASO DE CORONAS

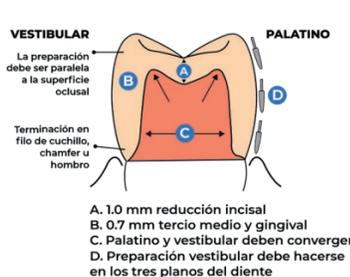

EN CASO DE CARILLAS

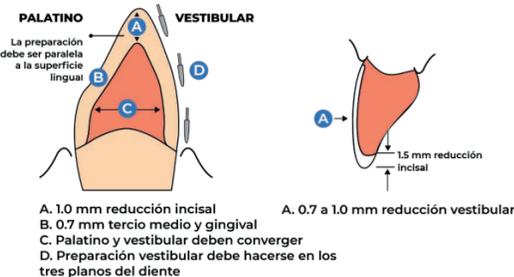

LOS PILARES PERSONALIZADOS Y T-BASE DE TITANIO/CRCO DIT® SON COMPATIBLES CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS

ZIMMER BIOMET	NOBEL BIOCARE	DENTIUM
ALPHA BIO	STRAUMANN	BIOHORIZONS
NEO BIOTECH	MEGAGEN	ANKYLOS
THOMMEN	MIS SEVEN	FALTOP

Fabricados bajo componentes Dit® de la fabrica con equipo original de alta tecnología Suiza y digital. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Nuestros componentes poseen un stock limitado consultar disponibilidad previa y compatibilidad.

* Una orden de trabajo completa detallada evita llamados innecesarios e inconvenientes en tus casos.